



Funcionamiento del Flatpanel en el sistema de rayos x con soporte giratorio.

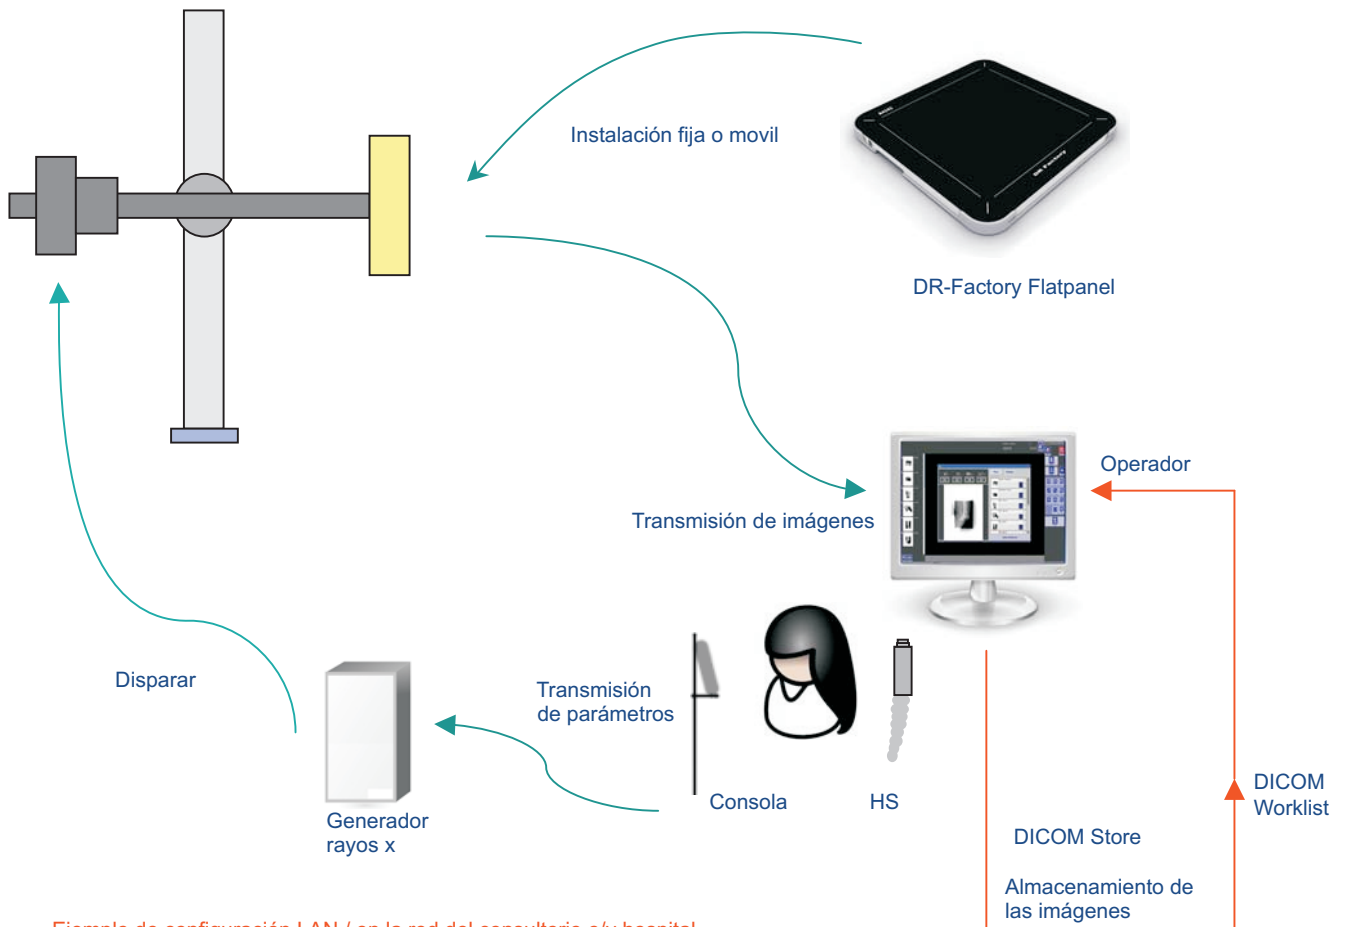

Ejemplo de configuración LAN / en la red del consultorio o/y hospital

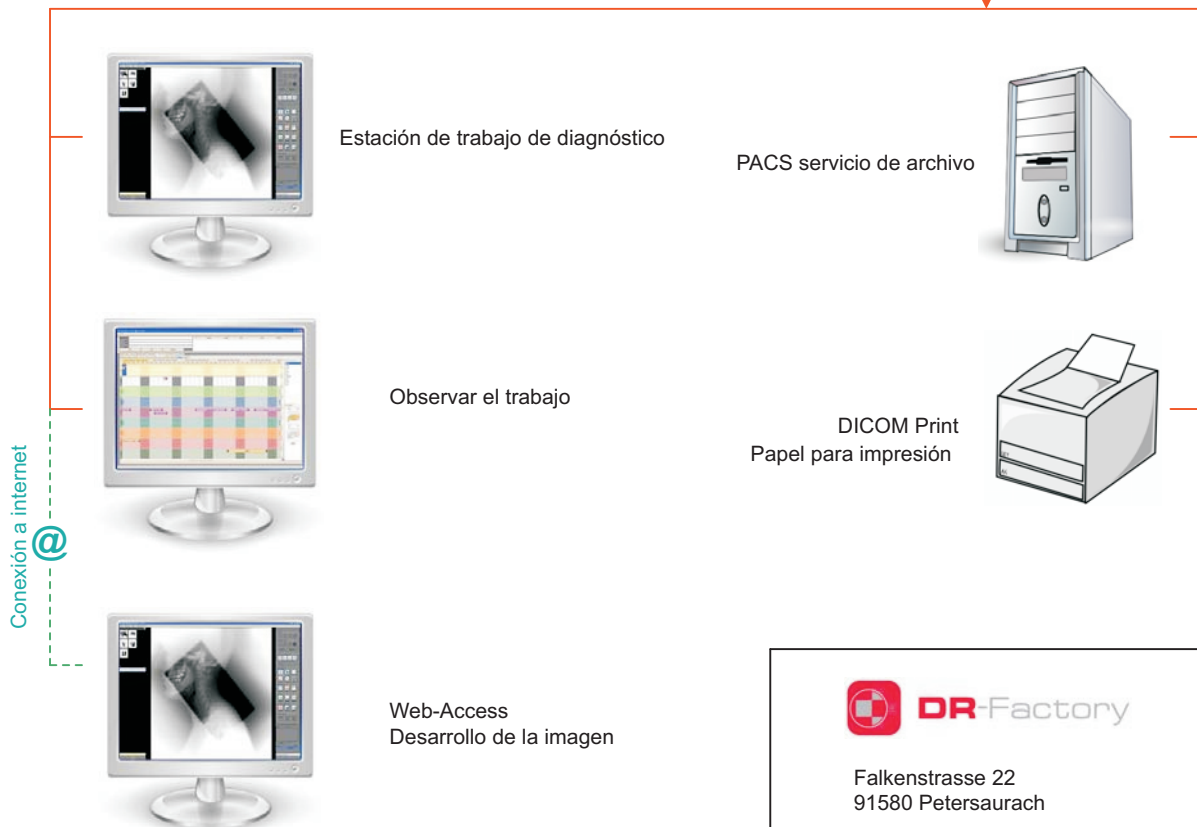

Falkenstrasse 22
91580 Petersaurach
Tel.: 0 98 72 / 20 02
Fax: 0 98 72 / 28 23